


BLOCCHETTO PER BOCCOLE IN TITANIO PER CHIRURGIA GUIDATA

Il blocchetto, realizzato in titanio grado medicale 5, viene utilizzato nella procedura di chirurgia guidata qualora si usino le boccole in titanio.

Quando la fresa utilizzata con la relativa boccola ha terminato il fresaggio del sito implantare, il blocchetto risulta un valido supporto per la boccola in modo da favorire il disassemblaggio dalla fresa.

Il blocchetto ha le sedi per le boccole per tutti i diametri implantari XCN®: vi sono infatti riportate le marcature laser con il diametro e il relativo codice colore.

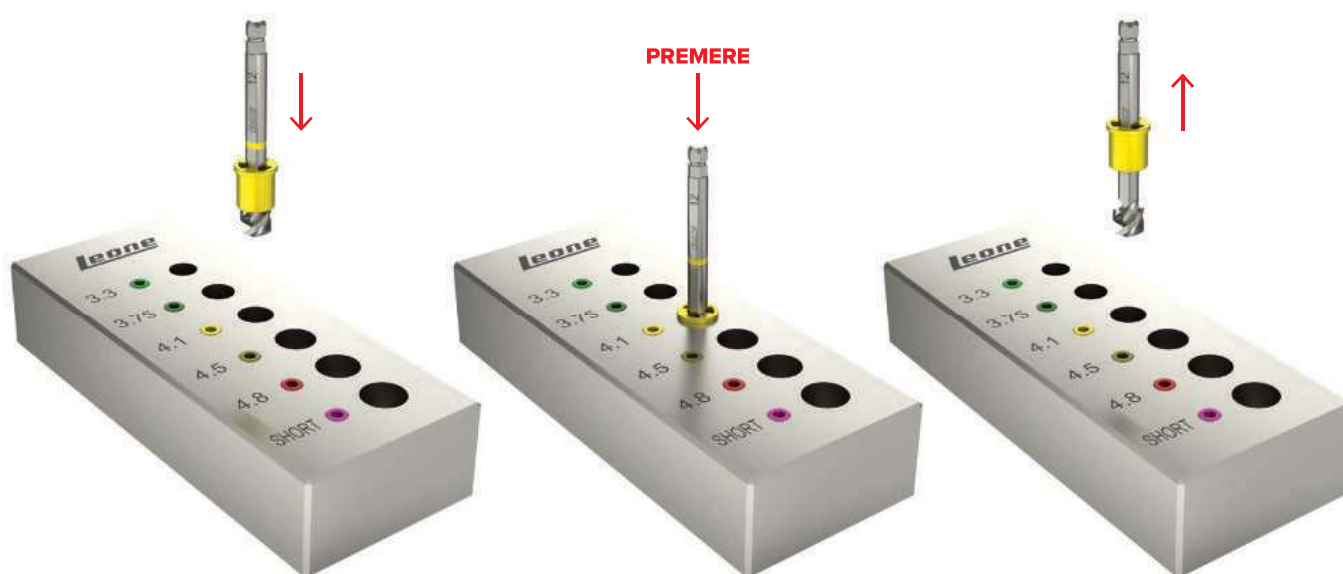

- fabbricato in titanio grado medicale 5
- utilizzato come supporto per le boccole in titanio per disassemblare l'assieme boccola-fresa dopo l'utilizzo di quest'ultima
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

REF 156-0002-54
EURO 86,00 +IVA